

抑制視野の検査-プリズムによる赤フィルタを装用する方法(広さの検査)




目的

抑制暗点の広さの計測

準備物 固視灯・赤フィルタ・バプリズム(又はロータリープリズム)

参考) 金谷まり子: 視能矯正マニュアル P154


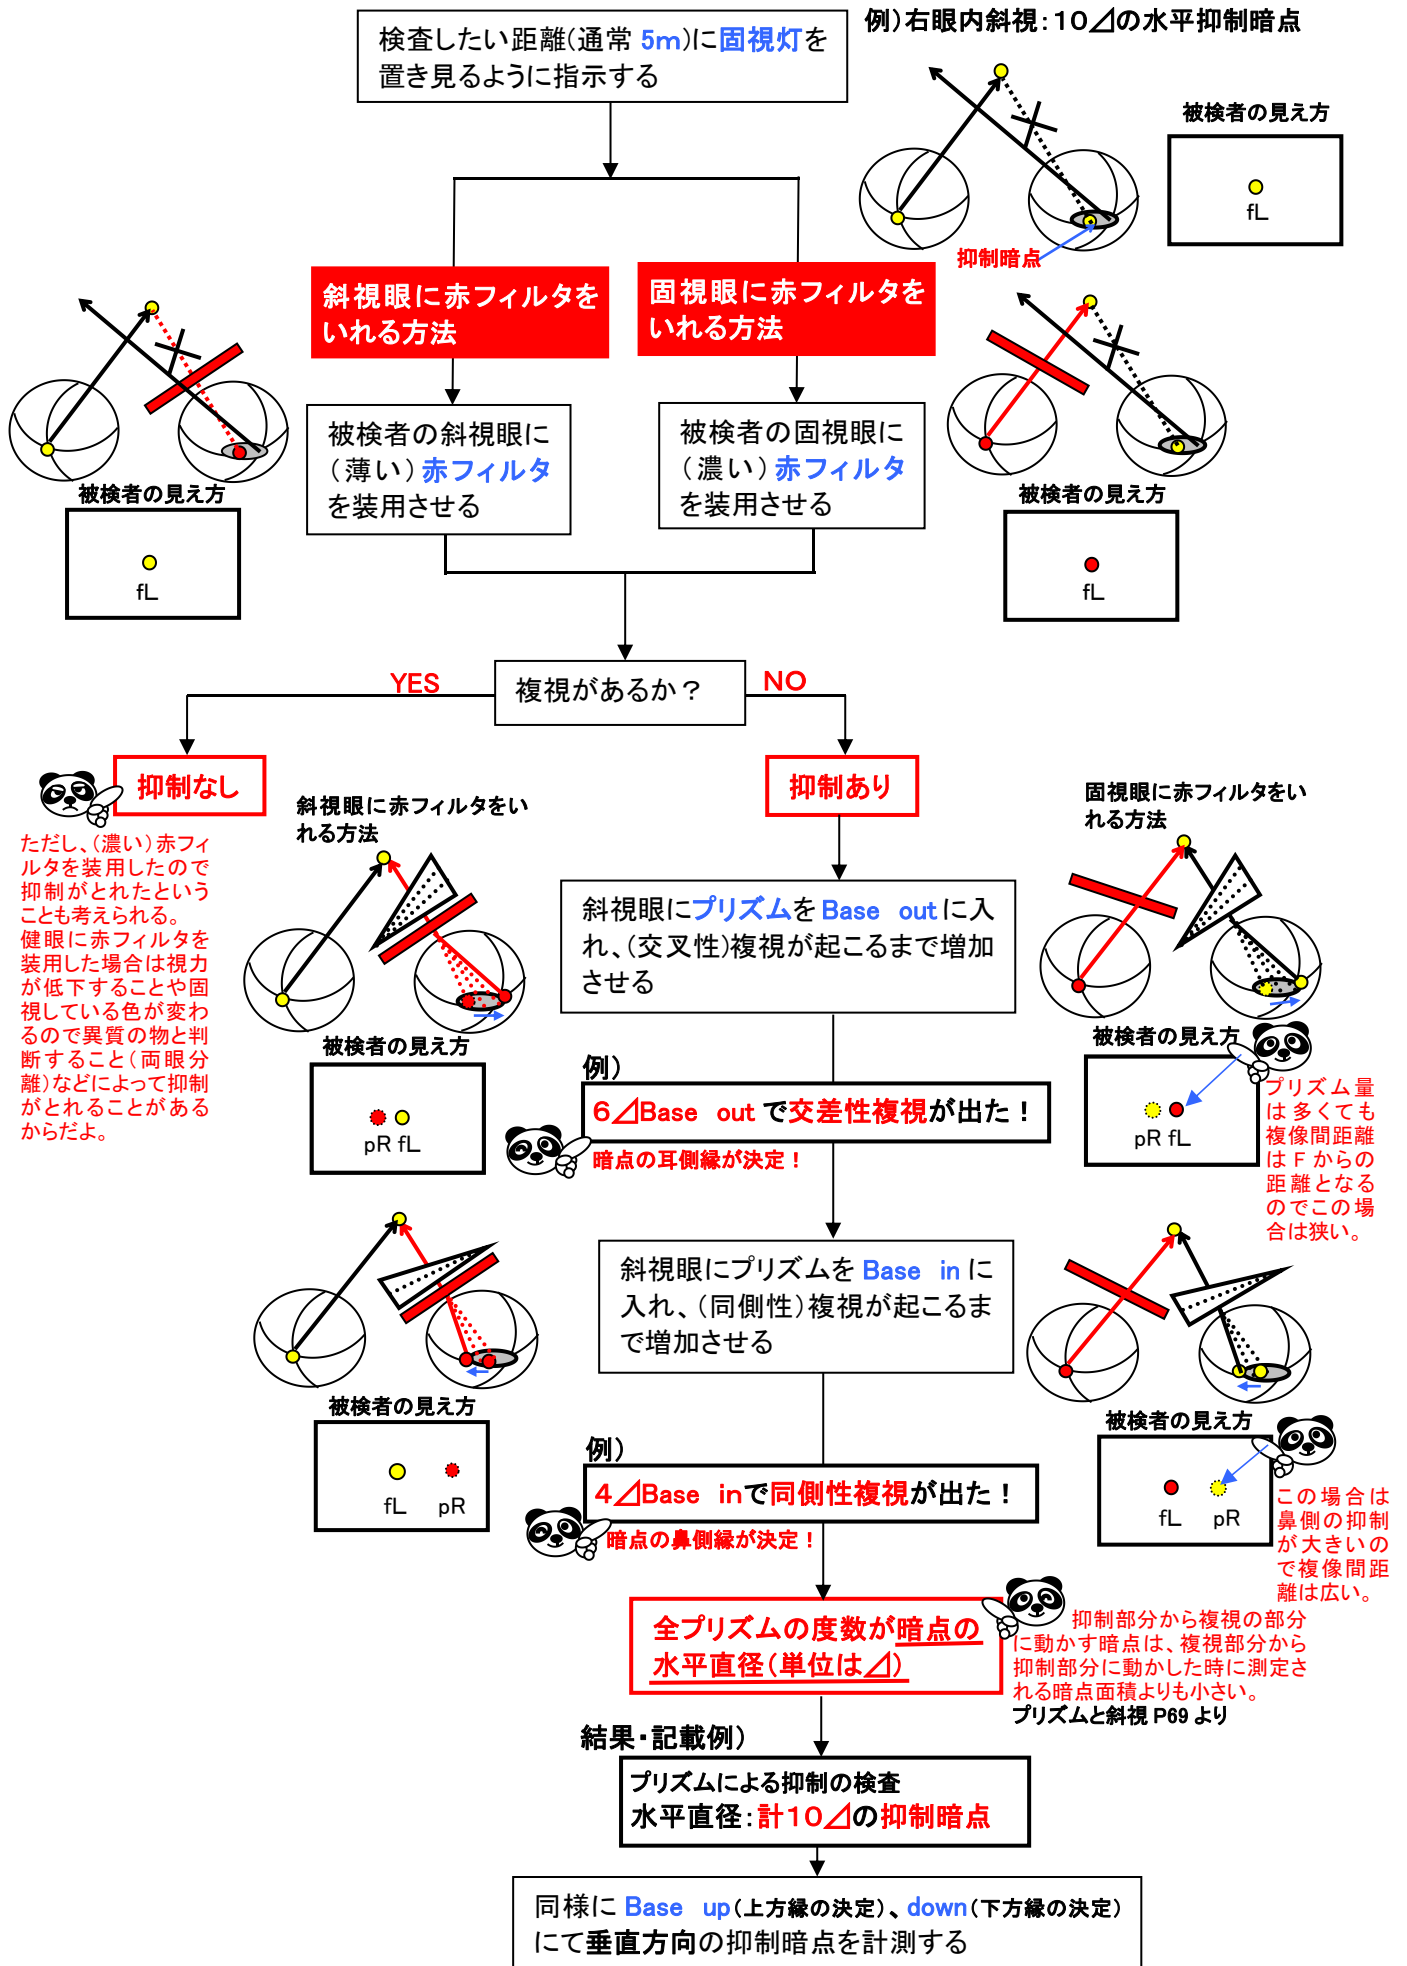


赤フィルタを装用する方法で左眼外斜視で抑制がある場合のそれぞれの見え方を図示せよ。



斜視眼に赤フィルタをいれる方法

固視眼に赤フィルタをいれる方法

プリズム装用前





他覚的斜視角量のプリズムを基底外方に装用

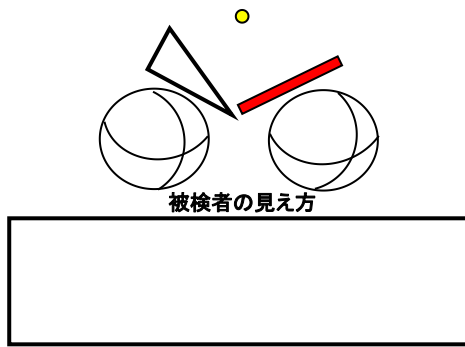

複視

複視

他覚的斜視角量より多くのプリズムを基底内方に装用



複視

複視

赤フィルタを装用する方法で左眼外斜視で抑制がある場合のプリズム量によるそれぞれの見え方を図示せよ。

